

# 2025 年 04 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告


## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

| G6PD         | Control N<br>(Lot No.:BD0728N) | Control D<br>(Lot No.: BD0728D) |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 參加單位         | 6                              | 6                               |
| 總回報數 (n)     | 50                             | 50                              |
| 中位數 (Median) | 14.9 (U/g Hb)                  | 4.4 (U/g Hb)                    |
| 平均值 (Mean)   | 15.2 (U/g Hb)                  | 4.6 (U/g Hb)                    |
| 標準差 (SD)     | 1.4                            | 0.5                             |
| 變異係數 (CV)    | 9.2%                           | 10.9%                           |
| G6PD 檢驗值範圍   | 13.4 ~ 18.2 (U/g Hb)           | 4.0 ~ 5.6 (U/g Hb)              |
| Hb 檢驗值範圍     | 2.5 ~ 2.8 (g/dL)               | 2.2 ~ 2.7 (g/dL)                |

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Innovation kit, 37°C

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

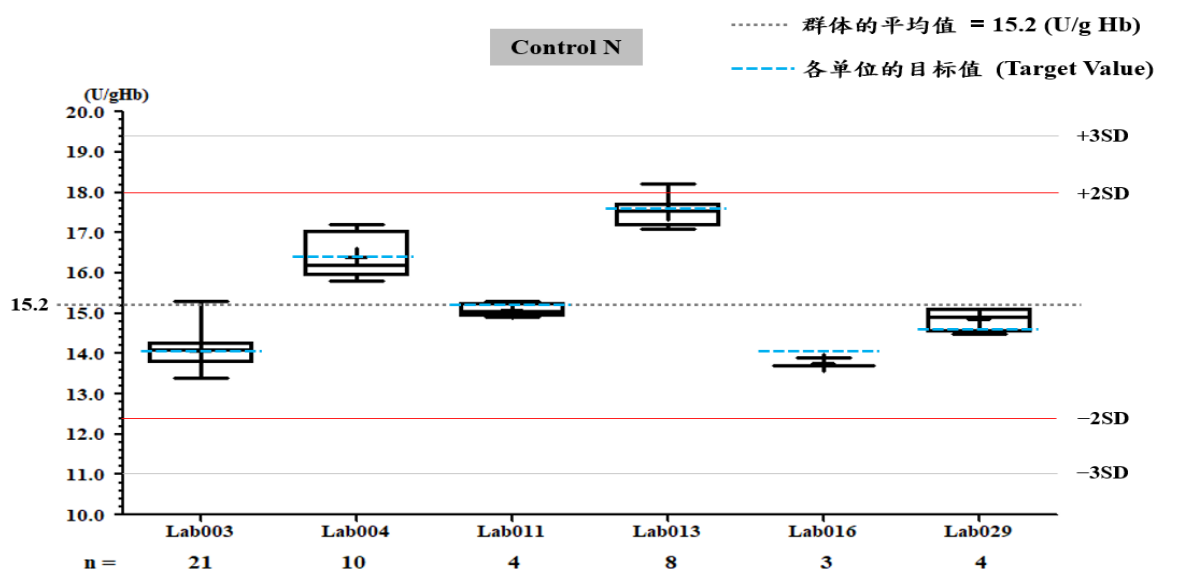

圖例說明

