

G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo : AA1223N (2012-10-01 ~ 2100-12-31) [Change](#)

[列印圖表](#)

檢驗單位 : **Lab014**


QC Control Lot No.	Control N		Control D	
	AA1223N		AA1223D	
檢驗期間	Month (2015/04)	CUM (2014/12/23~2015/04/30)	Month (2015/04)	CUM (2014/12/23~2015/04/30)
累計點數 (N)	7	26	7	26
累計平均值 (Mean) U/gHb	15.6	15.1	4.5	4.2
累計標準差 (SD)	0.5	0.4	0.1	0.2
累計變異係數 (CV) %	3.2	2.6	2.2	4.8
目標值 (Target) U/gHb	15.4	15.4	4.3	4.3
總誤差 (TE) %	7.7	7.2	9.1	11.8
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
σ	5.8	>6	>6	3.7

誤差 (Bias)% = $\{ [| \text{累計平均值 (Mean)} - \text{目標值 (Target)} |] / \text{目標值 (Target)} \} \times 100\%$
 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
 σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2015 04 [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 12 23 至 2015 04 30 [Change](#)

[TOP](#)


Control N SDI 分佈圖

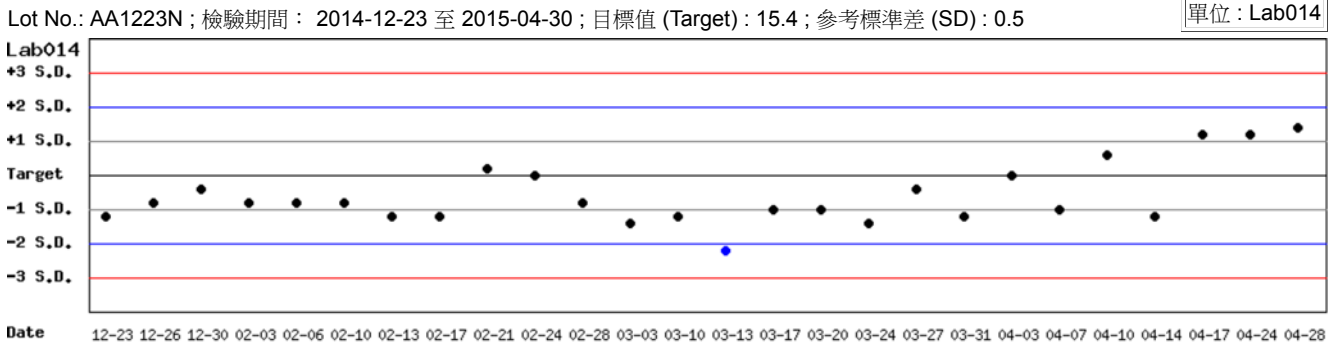

月統計 : 2015 04 [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 12 23 至 2015 04 30 [Change](#)

[TOP](#)

Control D SDI 分佈圖

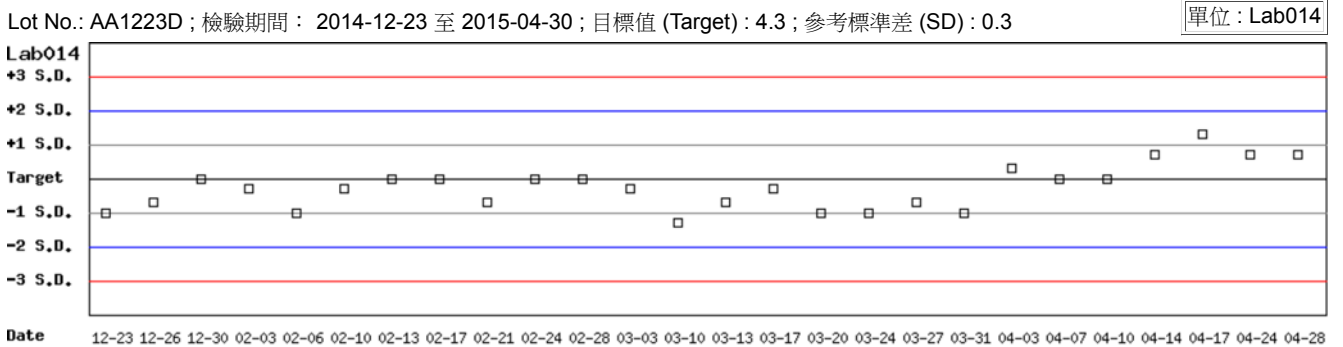

月統計 : 2015 04 [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 12 23 至 2015 04 30 [Change](#)


[TOP](#)

Control N 及 Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AA1223N ; 檢驗期間 : 2014-12-23 至 2015-04-30 ; 目標值 (Target) : 15.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.5 (●)

Lot No.: AA1223D ; 檢驗期間 : 2014-12-23 至 2015-04-30 ; 目標值 (Target) : 4.3 ; 參考標準差 (SD) : 0.3 (□)

單位 : Lab014

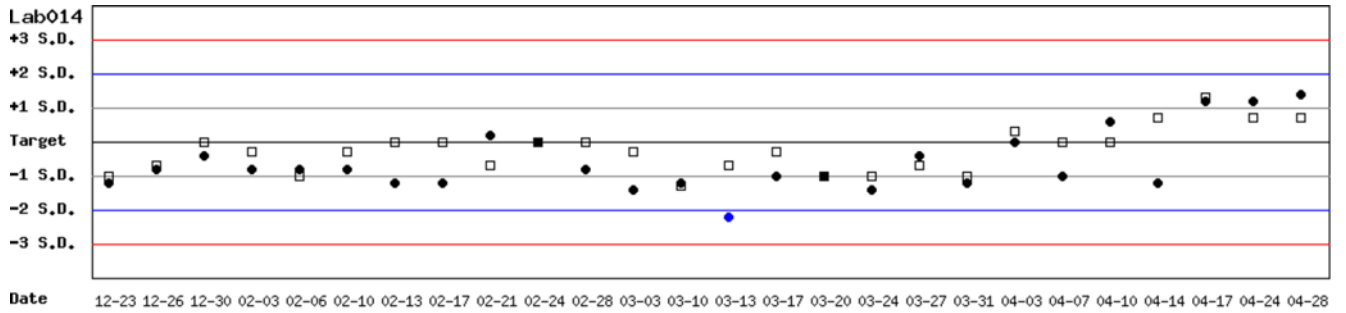

月統計 : 2015 04 ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 12 23 至 2015 04 30

[TOP](#)