


2015年05月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

| G6PD | Control N (Lot No.:AD0326N) | Control D (Lot No.:AD0326D) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 參加單位 | 13 | 13 |
| 總回報數 (n) | 94 | 94 |
| 中位數 (Median) | 14.9 (U/gHb) | 4.8 (U/gHb) |
| 平均值 (Mean) | 14.7 (U/gHb) | 4.9 (U/gHb) |
| 標準差 (SD) | 0.7 | 0.3 |
| 變異係數 (CV) | 4.8% | 6.1% |
| G6PD 檢驗值範圍 | 12.9 ~ 16.1 (U/gHb) | 4.1 ~ 5.5 (U/gHb) |
| Hb 檢驗值範圍 | 2.2 ~ 2.7 (g/dL) | 2.2 ~ 4.5 (g/dL) |

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

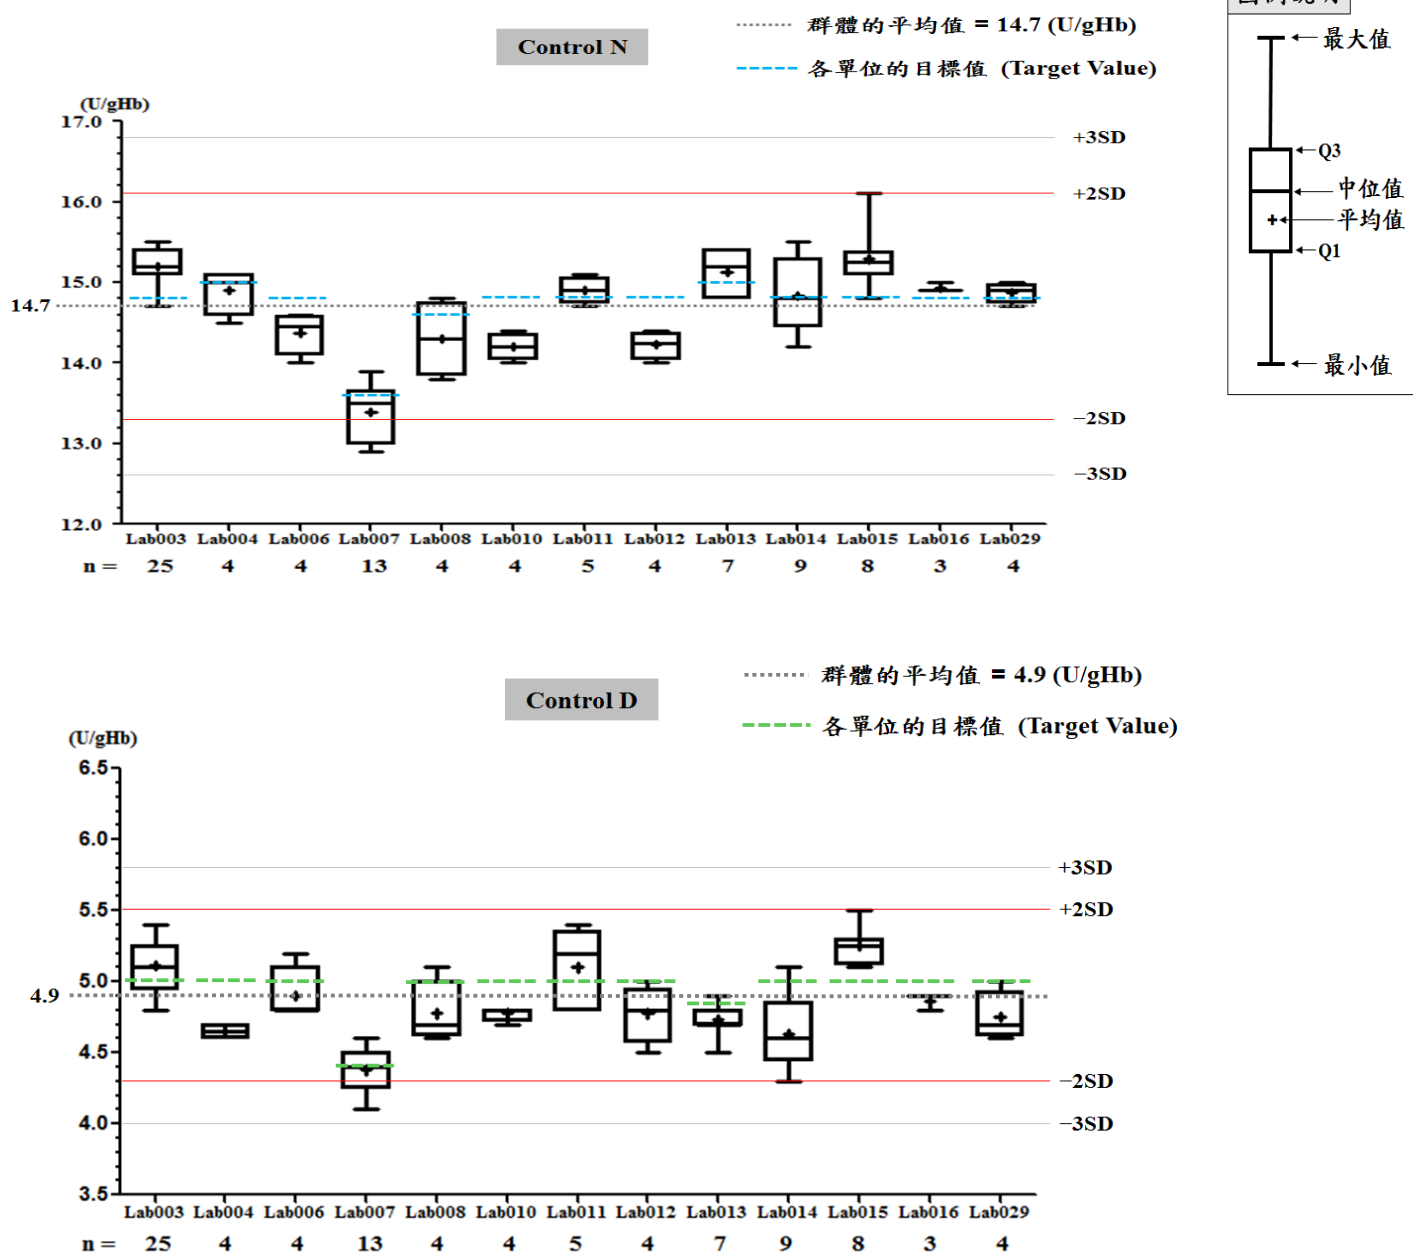

G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo : AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) [Change](#)

[列印圖表](#)

檢驗單位 : **Lab012**

| QC Control Lot No. | Control N | | Control D | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | AD0326N | | AD0326D | |
| 檢驗期間 | Month (2015/05) | CUM (2014/11/19~2015/05/31) | Month (2015/05) | CUM (2014/11/19~2015/05/31) |
| 累計點數 (N) | 4 | 26 | 4 | 26 |
| 累計平均值 (Mean) U/gHb | 14.2 | 14.5 | 4.8 | 4.7 |
| 累計標準差 (SD) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 累計變異係數 (CV) % | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 4.3 |
| 目標值 (Target) U/gHb | 14.8 | 14.8 | 5.0 | 5.0 |
| 總誤差 (TE) % | 6.9 | 6.2 | 12.3 | 14.5 |
| 可容許總誤差 (TEa) % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| σ | >6 | >6 | 3.8 | 3.3 |

誤差 (Bias)% = $\{ [| \text{累計平均值 (Mean)} - \text{目標值 (Target)} |] / \text{目標值 (Target)} \} \times 100\%$

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)


月統計 : 2015 05 [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 11 19 至 2015 05 31 [Change](#)

[TOP](#)

Control N SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326N ; 檢驗期間 : 2014-11-19 至 2015-05-31 ; 目標值 (Target) : 14.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.5

單位 : Lab012

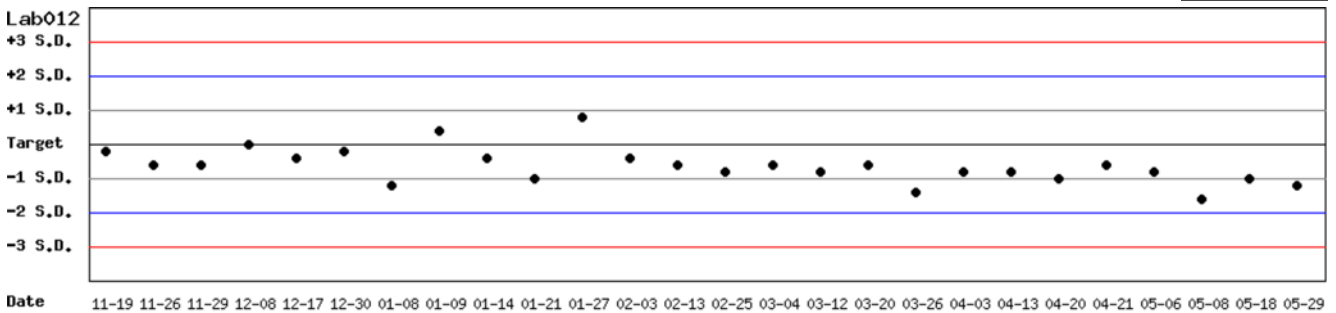


月統計 : 2015 05 [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 11 19 至 2015 05 31 [Change](#)

[TOP](#)

Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326D ; 檢驗期間 : 2014-11-19 至 2015-05-31 ; 目標值 (Target) : 5.0 ; 參考標準差 (SD) : 0.3

單位 : Lab012

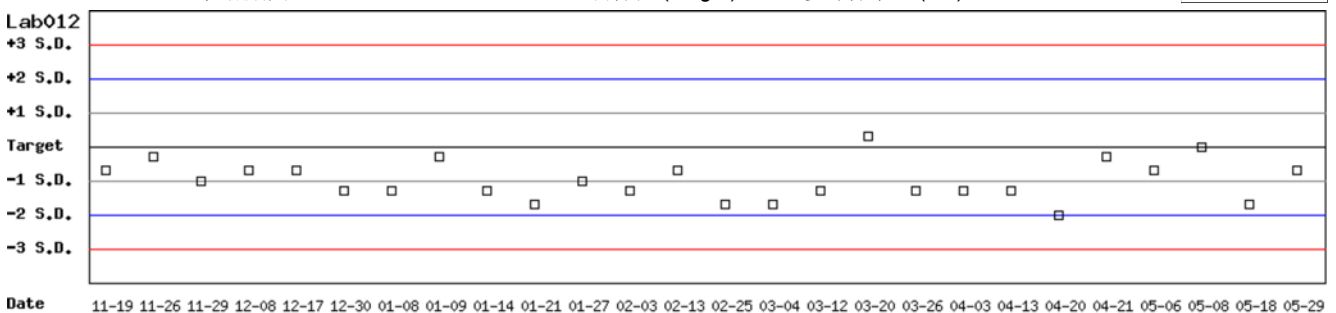

月統計 : 2015 05 [Change](#) ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 11 19 至 2015 05 31 [Change](#)


[TOP](#)

Control N 及 Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326N ; 檢驗期間 : 2014-11-19 至 2015-05-31 ; 目標值 (Target) : 14.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.5 (●)

Lot No.: AD0326D ; 檢驗期間 : 2014-11-19 至 2015-05-31 ; 目標值 (Target) : 5.0 ; 參考標準差 (SD) : 0.3 (□)

單位 : Lab012

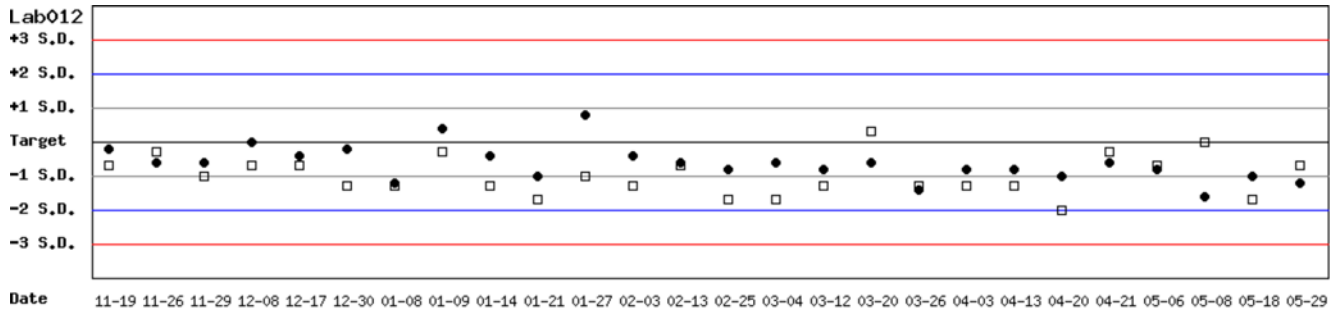

月統計 : 2015 05 ; 累計期間 (CUM) : 自 2014 11 19 至 2015 05 31

[\[TOP\]](#)

各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 (總表一)

選擇 LotNo : AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) ▼ Change

選擇 Reagent Kit : 1 - Trinity ▼ Change

列印總表一

月統計表

統計月份 : 2015 ▼ 05 ▼ Change

| UnitID [↑] | Reagent Kit (Code) [↑] | Control N (Lot No.: AD0326N) | | | | | | | | | Control D (Lot No.: AD0326D) | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|----------------|------------------------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--|--|
| | | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | | |
| Lab003 | 1 | 14.8 | 15.2 | 25 | 0.2 | 1.3 | 5.3 | 20 | >6 | 5.0 | 5.1 | 25 | 0.2 | 3.9 | 9.8 | 20 | 4.6 | | |
| Lab004 | 1 | 15.0 | 14.9 | 4 | 0.3 | 2.0 | 4.7 | 20 | >6 | 5.0 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.1 | 10.3 | 20 | >6 | | |
| Lab006 | 1 | 14.8 | 14.4 | 4 | 0.3 | 2.1 | 6.9 | 20 | >6 | 5.0 | 4.9 | 4 | 0.2 | 4.1 | 10.2 | 20 | 4.4 | | |
| Lab007 | 1 | 13.6 | 13.4 | 13 | 0.3 | 2.2 | 5.9 | 20 | >6 | 4.4 | 4.4 | 13 | 0.2 | 4.5 | 9.1 | 20 | 4.4 | | |
| Lab008 | 1 | 14.6 | 14.3 | 4 | 0.5 | 3.5 | 9.0 | 20 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | | |
| Lab010 | 1 | 14.8 | 14.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 6.9 | 20 | >6 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.1 | 8.2 | 20 | >6 | | |
| Lab011 | 1 | 14.8 | 14.9 | 5 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 20 | >6 | 5.0 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.9 | 13.8 | 20 | 3.1 | | |
| Lab012 | 1 | 14.8 | 14.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 6.9 | 20 | >6 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | | |
| Lab013 | 1 | 15.0 | 15.1 | 7 | 0.3 | 2.0 | 4.6 | 20 | >6 | 4.7 | 4.7 | 7 | 0.1 | 2.1 | 4.3 | 20 | >6 | | |
| Lab014 | 1 | 14.8 | 14.8 | 9 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 20 | 5.9 | 5.0 | 4.6 | 9 | 0.3 | 6.5 | 21.0 | 20 | 1.8 | | |
| Lab015 | 1 | 14.8 | 15.3 | 8 | 0.4 | 2.6 | 8.6 | 20 | >6 | 5.0 | 5.3 | 8 | 0.1 | 1.9 | 9.8 | 20 | >6 | | |
| Lab016 | 1 | 14.8 | 14.9 | 3 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 20 | >6 | 5.0 | 4.9 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.1 | 20 | >6 | | |
| Lab029 | 1 | 14.8 | 14.9 | 4 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 20 | >6 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | | |
| Total | - | - | 14.7 | 94 | 0.7 | 4.8 | - | - | - | - | 4.9 | 94 | 0.3 | 6.1 | - | - | - | | |

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

累計統計表

累計期間 : 自 2014 ▼ 05 ▼ 01 ▼ 至 2015 ▼ 05 ▼ 31 ▼ Change

| UnitID [↑] | Reagent Kit (Code) [↑] | Control N (Lot No.: AD0326N) | | | | | | | | | Control D (Lot No.: AD0326D) | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|----------------|------------------------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--|--|
| | | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | | |
| Lab001 | 1 | 14.2 | 14.8 | 1 | - | - | - | 20 | - | 4.6 | 5.0 | 1 | - | - | - | 20 | - | | |
| Lab003 | 1 | 14.8 | 14.5 | 307 | 0.7 | 4.8 | 11.7 | 20 | 3.7 | 5.0 | 4.9 | 307 | 0.3 | 6.1 | 14.2 | 20 | 3.0 | | |
| Lab004 | 1 | 15.0 | 15.0 | 38 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 20 | >6 | 5.0 | 4.9 | 38 | 0.2 | 4.1 | 10.2 | 20 | 4.4 | | |
| Lab006 | 1 | 14.8 | 15.0 | 35 | 0.7 | 4.7 | 10.7 | 20 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 35 | 0.4 | 7.8 | 17.7 | 20 | 2.3 | | |
| Lab007 | 1 | 13.6 | 13.6 | 132 | 0.5 | 3.7 | 7.4 | 20 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 132 | 0.2 | 4.5 | 9.1 | 20 | 4.4 | | |
| Lab008 | 1 | 14.6 | 14.5 | 51 | 0.6 | 4.1 | 9.0 | 20 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 51 | 0.3 | 6.8 | 25.6 | 20 | 1.2 | | |
| Lab010 | 1 | 14.8 | 14.0 | 37 | 0.4 | 2.9 | 11.1 | 20 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 37 | 0.2 | 4.3 | 14.5 | 20 | 3.3 | | |
| Lab011 | 1 | 14.8 | 14.9 | 48 | 0.3 | 2.0 | 4.7 | 20 | >6 | 5.0 | 5.0 | 48 | 0.3 | 6.0 | 12.0 | 20 | 3.3 | | |
| Lab012 | 1 | 14.8 | 14.6 | 33 | 0.4 | 2.7 | 6.8 | 20 | >6 | 5.0 | 4.8 | 33 | 0.3 | 6.3 | 16.5 | 20 | 2.5 | | |
| Lab013 | 1 | 15.0 | 15.0 | 65 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 20 | >6 | 4.7 | 4.7 | 65 | 0.2 | 4.3 | 8.5 | 20 | 4.7 | | |
| Lab014 | 1 | 14.8 | 14.8 | 9 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 20 | 5.9 | 5.0 | 4.6 | 9 | 0.3 | 6.5 | 21.0 | 20 | 1.8 | | |
| Lab015 | 1 | 14.8 | 14.6 | 54 | 0.7 | 4.8 | 10.9 | 20 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 54 | 0.3 | 6.0 | 12.0 | 20 | 3.3 | | |
| Lab016 | 1 | 14.8 | 14.9 | 20 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 20 | >6 | 5.0 | 4.8 | 20 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | | |
| Lab029 | 1 | 14.8 | 14.9 | 43 | 0.4 | 2.7 | 6.0 | 20 | >6 | 5.0 | 4.8 | 43 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | | |
| Total | - | - | 14.5 | 873 | 0.7 | 4.8 | - | - | - | - | 4.8 | 873 | 0.3 | 6.3 | - | - | - | | |

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

| Reagent Kit | Reagent Code |
|-------------|--------------|
| Trinity | 1 |

各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 (總表二)

選擇 LotNo :

選擇 Reagent Kit :

Control N 月統計與累計統計之比較表

| | | Control N (Lot No.: AD0326N) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|-----------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|
| | | Month (2015/05) | | | | | | | | CUM (2014/05/01~2015/05/31) | | | | | | | |
| UnitID [⬇] | Reagent Kit (Code) [⬇] | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ |
| Lab001 | 1 | 14.2 | - | 0 | - | - | - | 20 | - | 14.2 | 14.8 | 1 | - | - | - | 20 | - |
| Lab003 | 1 | 14.8 | 15.2 | 25 | 0.2 | 1.3 | 5.3 | 20 | >6 | 14.8 | 14.5 | 307 | 0.7 | 4.8 | 11.7 | 20 | 3.7 |
| Lab004 | 1 | 15.0 | 14.9 | 4 | 0.3 | 2.0 | 4.7 | 20 | >6 | 15.0 | 15.0 | 38 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 20 | >6 |
| Lab006 | 1 | 14.8 | 14.4 | 4 | 0.3 | 2.1 | 6.9 | 20 | >6 | 14.8 | 15.0 | 35 | 0.7 | 4.7 | 10.7 | 20 | 4.0 |
| Lab007 | 1 | 13.6 | 13.4 | 13 | 0.3 | 2.2 | 5.9 | 20 | >6 | 13.6 | 13.6 | 132 | 0.5 | 3.7 | 7.4 | 20 | 5.4 |
| Lab008 | 1 | 14.6 | 14.3 | 4 | 0.5 | 3.5 | 9.0 | 20 | 5.1 | 14.6 | 14.5 | 51 | 0.6 | 4.1 | 9.0 | 20 | 4.7 |
| Lab010 | 1 | 14.8 | 14.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 6.9 | 20 | >6 | 14.8 | 14.0 | 37 | 0.4 | 2.9 | 11.1 | 20 | 5.0 |
| Lab011 | 1 | 14.8 | 14.9 | 5 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 20 | >6 | 14.8 | 14.9 | 48 | 0.3 | 2.0 | 4.7 | 20 | >6 |
| Lab012 | 1 | 14.8 | 14.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 6.9 | 20 | >6 | 14.8 | 14.6 | 33 | 0.4 | 2.7 | 6.8 | 20 | >6 |
| Lab013 | 1 | 15.0 | 15.1 | 7 | 0.3 | 2.0 | 4.6 | 20 | >6 | 15.0 | 15.0 | 65 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 20 | >6 |
| Lab014 | 1 | 14.8 | 14.8 | 9 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 20 | 5.9 | 14.8 | 14.8 | 9 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 20 | 5.9 |
| Lab015 | 1 | 14.8 | 15.3 | 8 | 0.4 | 2.6 | 8.6 | 20 | >6 | 14.8 | 14.6 | 54 | 0.7 | 4.8 | 10.9 | 20 | 3.9 |
| Lab016 | 1 | 14.8 | 14.9 | 3 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 20 | >6 | 14.8 | 14.9 | 20 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 20 | >6 |
| Lab029 | 1 | 14.8 | 14.9 | 4 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 20 | >6 | 14.8 | 14.9 | 43 | 0.4 | 2.7 | 6.0 | 20 | >6 |
| Total | - | - | 14.7 | 94 | 0.7 | 4.8 | - | - | - | - | 14.5 | 873 | 0.7 | 4.8 | - | - | - |

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 :

累計期間 (CUM) : 自 至

[TOP](#)

Control D 月統計與累計統計之比較表

| | | Control D (Lot No.: AD0326D) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|-----------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|
| | | Month (2015/05) | | | | | | | | CUM (2014/05/01~2015/05/31) | | | | | | | |
| UnitID [⬇] | Reagent Kit (Code) [⬇] | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ |
| Lab001 | 1 | 4.6 | - | 0 | - | - | - | 20 | - | 4.6 | 5.0 | 1 | - | - | - | 20 | - |
| Lab003 | 1 | 5.0 | 5.1 | 25 | 0.2 | 3.9 | 9.8 | 20 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 307 | 0.3 | 6.1 | 14.2 | 20 | 3.0 |
| Lab004 | 1 | 5.0 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.1 | 10.3 | 20 | >6 | 5.0 | 4.9 | 38 | 0.2 | 4.1 | 10.2 | 20 | 4.4 |
| Lab006 | 1 | 5.0 | 4.9 | 4 | 0.2 | 4.1 | 10.2 | 20 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 35 | 0.4 | 7.8 | 17.7 | 20 | 2.3 |
| Lab007 | 1 | 4.4 | 4.4 | 13 | 0.2 | 4.5 | 9.1 | 20 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 132 | 0.2 | 4.5 | 9.1 | 20 | 4.4 |
| Lab008 | 1 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | 5.0 | 4.4 | 51 | 0.3 | 6.8 | 25.6 | 20 | 1.2 |
| Lab010 | 1 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.1 | 8.2 | 20 | >6 | 5.0 | 4.7 | 37 | 0.2 | 4.3 | 14.5 | 20 | 3.3 |
| Lab011 | 1 | 5.0 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.9 | 13.8 | 20 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 48 | 0.3 | 6.0 | 12.0 | 20 | 3.3 |
| Lab012 | 1 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | 33 | 0.3 | 6.3 | 16.5 | 20 | 2.5 |
| Lab013 | 1 | 4.7 | 4.7 | 7 | 0.1 | 2.1 | 4.3 | 20 | >6 | 4.7 | 4.7 | 65 | 0.2 | 4.3 | 8.5 | 20 | 4.7 |
| Lab014 | 1 | 5.0 | 4.6 | 9 | 0.3 | 6.5 | 21.0 | 20 | 1.8 | 5.0 | 4.6 | 9 | 0.3 | 6.5 | 21.0 | 20 | 1.8 |
| Lab015 | 1 | 5.0 | 5.3 | 8 | 0.1 | 1.9 | 9.8 | 20 | >6 | 5.0 | 5.0 | 54 | 0.3 | 6.0 | 12.0 | 20 | 3.3 |
| Lab016 | 1 | 5.0 | 4.9 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.1 | 20 | >6 | 5.0 | 4.8 | 20 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 |
| Lab029 | 1 | 5.0 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | 43 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 20 | 3.8 |
| Total | - | - | 4.9 | 94 | 0.3 | 6.1 | - | - | - | - | 4.8 | 873 | 0.3 | 6.3 | - | - | - |

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 :

累計期間 (CUM) : 自 至

[TOP](#)

| Reagent Kit | Reagent Code |
|-------------|--------------|
| Trinity | 1 |