2015 年 12 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AD0326N)	Control D (Lot No.:AD0326D)
參加單位	13	13
總回報數 (n)	100	100
中位數 (Median)	14.8 (U/gHb)	4.8 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.6 (U/gHb)	4.8 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.6	0.2
變異係數 (CV)	4.1%	4.2%
G6PD 檢驗值範圍	13.2 ~ 15.5 (U/gHb)	4.2 ~ 5.3 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.2 ~ 2.7 (g/dL)	2.1 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

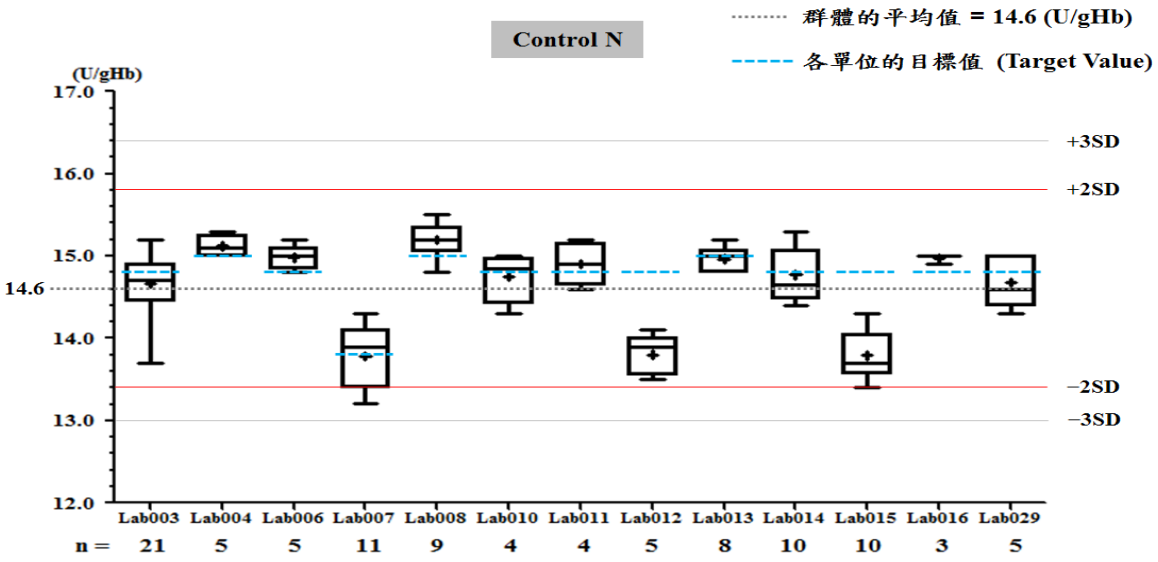

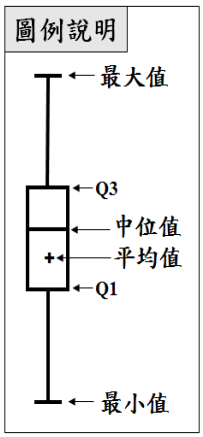

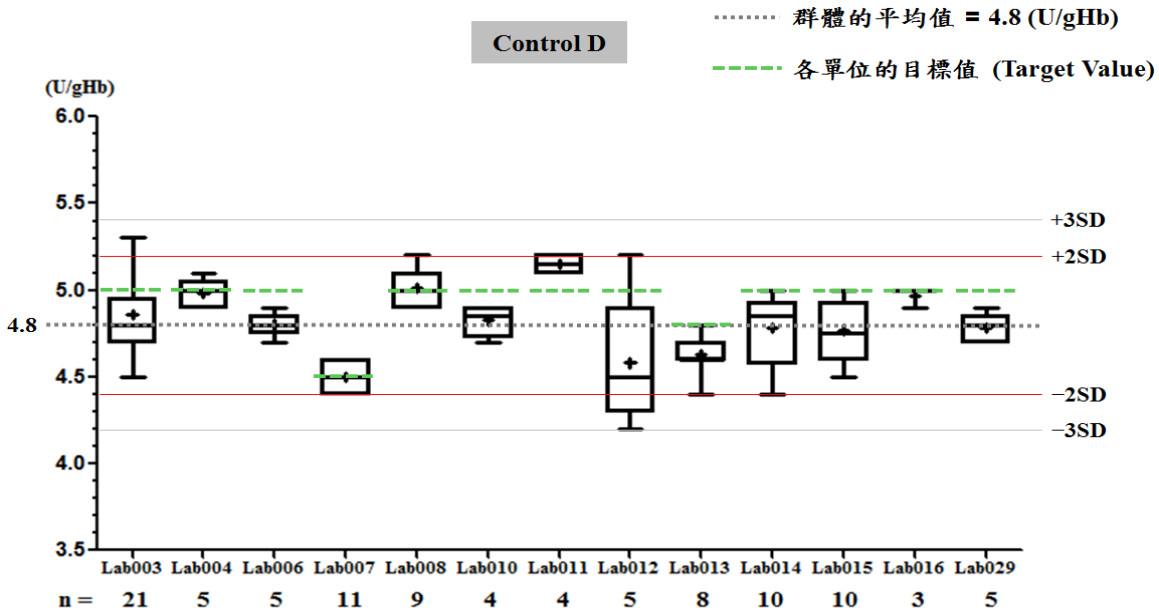

G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo： AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) Change

列印圖表

檢驗單位 : Lab015

	Control N		Control D	
QC Control Lot No.	AD0326N		AD0326D	
檢驗期間	Month (2015/12)	CUM (2015/10/13~2015/12/31)	Month (2015/12)	CUM (2015/10/13~2015/12/31)
累計點數 (N)	10	26	10	26
累計平均值 (Mean) U/gHb	13.8	13.9	4.8	4.8
累計標準差 (SD)	0.3	0.3	0.2	0.2
累計變異係數 (CV) %	2.2	2.2	4.2	4.2
目標值 (Target) U/gHb	14.8	14.8	5.0	5.0
總誤差 (TE) %	11.1	10.4	12.3	12.3
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
σ	>6	>6	3.8	3.8

誤差 (Bias)% = { [│累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2015 10 13 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Control N SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326N ; 檢驗期間： 2015-10-13 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 14.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.90

單位 : Lab015

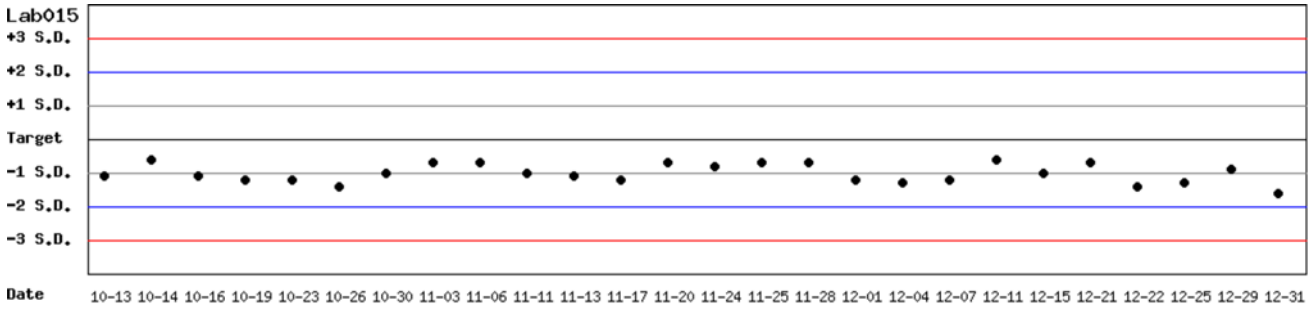

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2015 10 13 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326D ; 檢驗期間： 2015-10-13 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 5.0 ; 參考標準差 (SD) : 0.30

單位 : Lab015

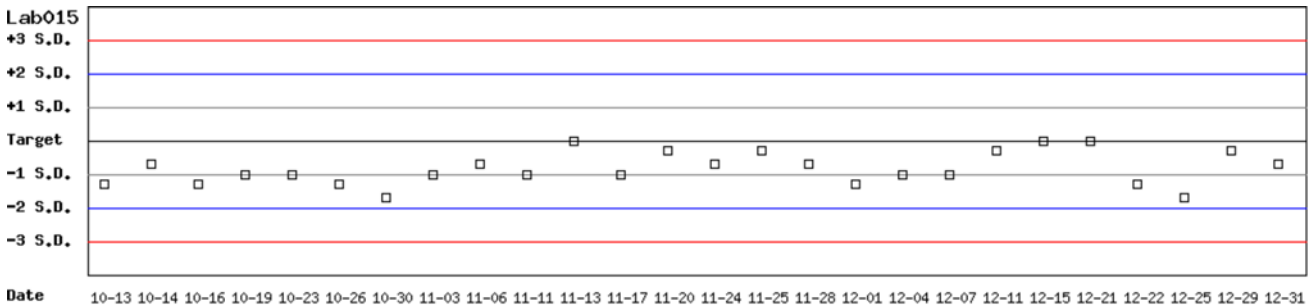

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2015 10 13 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Control N 及 Control D SDI
分佈圖

Lot No.: AD0326N ; 檢驗期間： 2015-10-13 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 14.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.90 (●)

Lot No.: AD0326D ; 檢驗期間： 2015-10-13 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 5.0 ; 參考標準差 (SD) : 0.30 (□)

單位 : Lab015

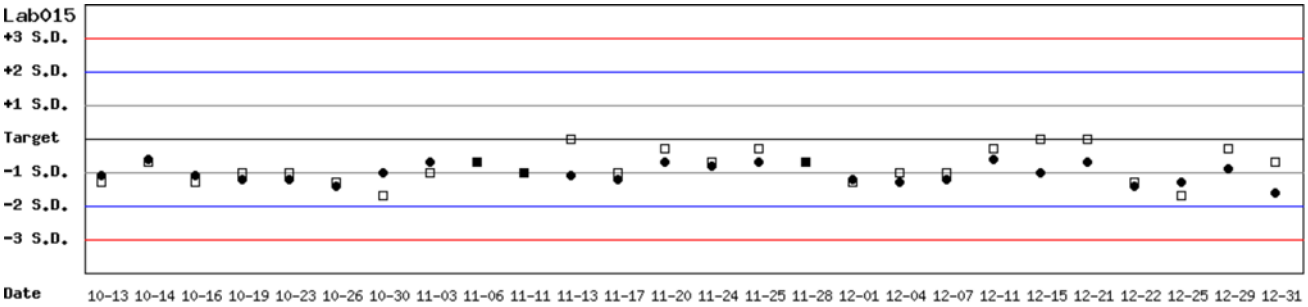

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2015 10 13 至 2015 12 31 Change

[TOP]

各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果（總表一）

選擇 LotNo：AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit：1 - Trinity Change

列印總表一

月統計表

統計月份： 2015 12 Change

		Control N (Lot No.: AD0326N)									Control D (Lot No.: AD0326D)							
UnitID	Reagent Kit (Code)	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab003	1	14.8	14.7	21	0.4	2.7	6.1	20	>6		5.0	4.9	21	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab004	1	15.0	15.1	5	0.1	0.7	2.0	20	>6		5.0	5.0	5	0.1	2.0	4.0	20	>6
Lab006	1	14.8	15.0	5	0.1	0.7	2.7	20	>6		5.0	4.8	5	0.1	2.1	8.2	20	>6
Lab007	1	13.8	13.8	11	0.4	2.9	5.8	20	>6		4.5	4.5	11	0.1	2.2	4.4	20	>6
Lab008	1	15.0	15.2	9	0.2	1.3	4.0	20	>6		5.0	5.0	9	0.1	2.0	4.0	20	>6
Lab010	1	14.8	14.8	4	0.3	2.0	4.1	20	>6		5.0	4.8	4	0.1	2.1	8.2	20	>6
Lab011	1	14.8	14.9	4	0.3	2.0	4.7	20	>6		5.0	5.2	4	0.1	1.9	7.8	20	>6
Lab012	1	14.8	13.8	5	0.2	1.4	9.7	20	>6		5.0	4.6	5	0.4	8.7	25.4	20	1.4
Lab013	1	15.0	15.0	8	0.2	1.3	2.7	20	>6		4.7	4.6	8	0.1	2.2	6.5	20	>6
Lab014	1	14.8	14.8	10	0.4	2.7	5.4	20	>6		5.0	4.8	10	0.2	4.2	12.3	20	3.8
Lab015	1	14.8	13.8	10	0.3	2.2	11.1	20	>6		5.0	4.8	10	0.2	4.2	12.3	20	3.8
Lab016	1	14.8	15.0	3	0.1	0.7	2.7	20	>6		5.0	5.0	3	0.1	2.0	4.0	20	>6
Lab029	1	14.8	14.7	5	0.3	2.0	4.8	20	>6		5.0	4.8	5	0.1	2.1	8.2	20	>6
Total	-	-	14.6	100	0.6	4.1	-	-	-		-	4.8	100	0.2	4.2	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [｜累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)｜] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP]

累計統計表

累計期間：自 2014 05 01 至 2015 12 31 Change

		Control N (Lot No.: AD0326N)									Control D (Lot No.: AD0326D)							
UnitID	Reagent Kit (Code)	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab001	1	14.2	14.8	1	-	-	-	20	-		4.6	5.0	1	-	-	-	20	-
Lab003	1	14.8	14.7	462	0.8	5.4	11.6	20	3.6		5.0	4.9	462	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab004	1	15.0	15.0	69	0.3	2.0	4.0	20	>6		5.0	4.9	69	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab006	1	14.8	14.8	64	0.7	4.7	9.5	20	4.3		5.0	4.9	64	0.4	8.2	18.3	20	2.2
Lab007	1	13.8	13.7	223	0.6	4.4	9.5	20	4.4		4.5	4.5	223	0.2	4.4	8.9	20	4.5
Lab008	1	15.0	14.4	110	0.7	4.9	13.7	20	3.3		5.0	4.6	110	0.3	6.5	21.0	20	1.8
Lab010	1	14.8	14.3	63	0.5	3.5	10.4	20	4.7		5.0	4.8	63	0.3	6.3	16.5	20	2.5
Lab011	1	14.8	15.0	77	0.3	2.0	5.4	20	>6		5.0	5.1	77	0.3	5.9	13.8	20	3.1
Lab012	1	14.8	14.4	66	0.4	2.8	8.3	20	>6		5.0	4.7	66	0.3	6.4	18.8	20	2.2
Lab013	1	15.0	15.0	128	0.2	1.3	2.7	20	>6		4.7	4.7	128	0.2	4.3	8.5	20	4.7
Lab014	1	14.8	14.7	73	0.4	2.7	6.1	20	>6		5.0	4.7	73	0.2	4.3	14.5	20	3.3
Lab015	1	14.8	14.5	122	0.8	5.5	13.1	20	3.3		5.0	4.9	122	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab016	1	14.8	14.9	35	0.1	0.7	2.0	20	>6		5.0	4.9	35	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab029	1	14.8	14.9	78	0.4	2.7	6.0	20	>6		5.0	4.9	78	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Total	-	-	14.5	1571	0.7	4.8	-	-	-		-	4.8	1571	0.3	6.3	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [｜累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)｜] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[TOP]

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1

各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果（總表二）

選擇 LotNo：AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit：1 - Trinity Change

列印總表二

Control N 月統計與累計統計之比較表

		Control N (Lot No.: AD0326N)															
		Month (2015/12)									CUM (2014/05/01~2015/12/31)						
UnitID	Reagent Kit (Code)	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab001	1	14.2	-	0	-	-	-	20	-		14.2	14.8	1	-	-	-	20	-
Lab003	1	14.8	14.7	21	0.4	2.7	6.1	20	>6		14.8	14.7	462	0.8	5.4	11.6	20	3.6
Lab004	1	15.0	15.1	5	0.1	0.7	2.0	20	>6		15.0	15.0	69	0.3	2.0	4.0	20	>6
Lab006	1	14.8	15.0	5	0.1	0.7	2.7	20	>6		14.8	14.8	64	0.7	4.7	9.5	20	4.3
Lab007	1	13.8	13.8	11	0.4	2.9	5.8	20	>6		13.8	13.7	223	0.6	4.4	9.5	20	4.4
Lab008	1	15.0	15.2	9	0.2	1.3	4.0	20	>6		15.0	14.4	110	0.7	4.9	13.7	20	3.3
Lab010	1	14.8	14.8	4	0.3	2.0	4.1	20	>6		14.8	14.3	63	0.5	3.5	10.4	20	4.7
Lab011	1	14.8	14.9	4	0.3	2.0	4.7	20	>6		14.8	15.0	77	0.3	2.0	5.4	20	>6
Lab012	1	14.8	13.8	5	0.2	1.4	9.7	20	>6		14.8	14.4	66	0.4	2.8	8.3	20	>6
Lab013	1	15.0	15.0	8	0.2	1.3	2.7	20	>6		15.0	15.0	128	0.2	1.3	2.7	20	>6
Lab014	1	14.8	14.8	10	0.4	2.7	5.4	20	>6		14.8	14.7	73	0.4	2.7	6.1	20	>6
Lab015	1	14.8	13.8	10	0.3	2.2	11.1	20	>6		14.8	14.5	122	0.8	5.5	13.1	20	3.3
Lab016	1	14.8	15.0	3	0.1	0.7	2.7	20	>6		14.8	14.9	35	0.1	0.7	2.0	20	>6
Lab029	1	14.8	14.7	5	0.3	2.0	4.8	20	>6		14.8	14.9	78	0.4	2.7	6.0	20	>6
Total	-	-	14.6	100	0.6	4.1	-	-	-		-	14.5	1571	0.7	4.8	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計： 2015 12 Change　　累計期間 (CUM)：自 2014 05 01 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Control D 月統計與累計統計之比較表

		Control D (Lot No.: AD0326D)															
		Month (2015/12)									CUM (2014/05/01~2015/12/31)						
UnitID	Reagent Kit (Code)	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab001	1	4.6	-	0	-	-	-	20	-		4.6	5.0	1	-	-	-	20	-
Lab003	1	5.0	4.9	21	0.2	4.1	10.2	20	4.4		5.0	4.9	462	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab004	1	5.0	5.0	5	0.1	2.0	4.0	20	>6		5.0	4.9	69	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab006	1	5.0	4.8	5	0.1	2.1	8.2	20	>6		5.0	4.9	64	0.4	8.2	18.3	20	2.2
Lab007	1	4.5	4.5	11	0.1	2.2	4.4	20	>6		4.5	4.5	223	0.2	4.4	8.9	20	4.5
Lab008	1	5.0	5.0	9	0.1	2.0	4.0	20	>6		5.0	4.6	110	0.3	6.5	21.0	20	1.8
Lab010	1	5.0	4.8	4	0.1	2.1	8.2	20	>6		5.0	4.8	63	0.3	6.3	16.5	20	2.5
Lab011	1	5.0	5.2	4	0.1	1.9	7.8	20	>6		5.0	5.1	77	0.3	5.9	13.8	20	3.1
Lab012	1	5.0	4.6	5	0.4	8.7	25.4	20	1.4		5.0	4.7	66	0.3	6.4	18.8	20	2.2
Lab013	1	4.7	4.6	8	0.1	2.2	6.5	20	>6		4.7	4.7	128	0.2	4.3	8.5	20	4.7
Lab014	1	5.0	4.8	10	0.2	4.2	12.3	20	3.8		5.0	4.7	73	0.2	4.3	14.5	20	3.3
Lab015	1	5.0	4.8	10	0.2	4.2	12.3	20	3.8		5.0	4.9	122	0.3	6.1	14.2	20	3.0
Lab016	1	5.0	5.0	3	0.1	2.0	4.0	20	>6		5.0	4.9	35	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Lab029	1	5.0	4.8	5	0.1	2.1	8.2	20	>6		5.0	4.9	78	0.2	4.1	10.2	20	4.4
Total	-	-	4.8	100	0.2	4.2	-	-	-		-	4.8	1571	0.3	6.3	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計： 2015 12 Change　　累計期間 (CUM)：自 2014 05 01 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1