G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo： AA1223N (2012-10-01 ~ 2100-12-31) Change

列印圖表

檢驗單位 : Lab030

	Control N		Control D	
QC Control Lot No.	AA1223N		AA1223D	
檢驗期間	Month (2015/12)	CUM (2013/10/08~2015/12/31)	Month (2015/12)	CUM (2013/10/08~2015/12/31)
累計點數 (N)	1	26	1	26
累計平均值 (Mean) U/gHb	14.9	14.9	4.3	4.7
累計標準差 (SD)	-	0.6	-	0.4
累計變異係數 (CV) %	-	4.0	-	8.5
目標值 (Target) U/gHb	15.4	15.4	4.3	4.3
總誤差 (TE) %	-	11.3	-	26.3
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
σ	-	4.2	-	1.3

誤差 (Bias)% = { [│累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2013 10 08 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Control N SDI 分佈圖

Lot No.: AA1223N ; 檢驗期間： 2013-10-08 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 15.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.5

單位 : Lab030

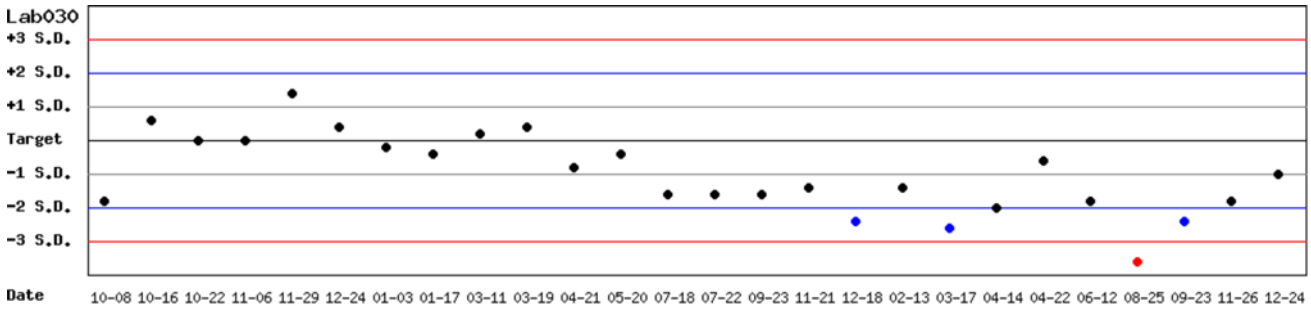

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2013 10 08 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AA1223D ; 檢驗期間： 2013-10-08 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 4.3 ; 參考標準差 (SD) : 0.3

單位 : Lab030

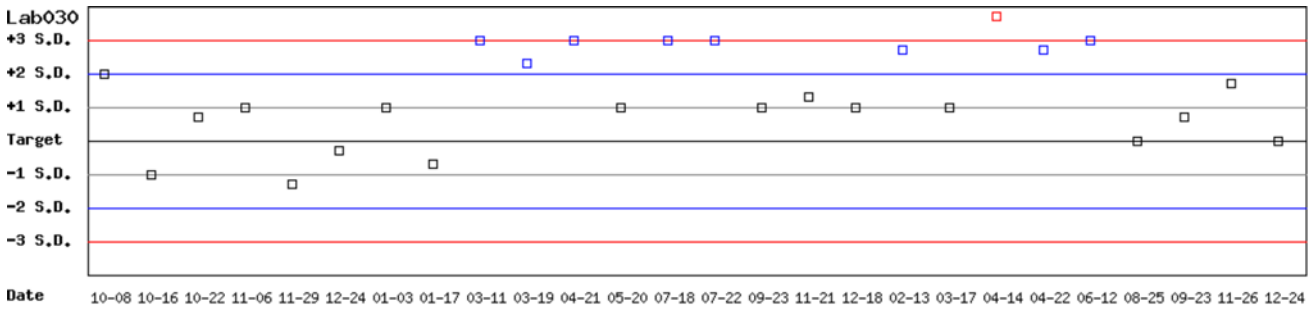

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2013 10 08 至 2015 12 31 Change

[TOP]

Control N 及 Control D SDI
分佈圖

Lot No.: AA1223N ; 檢驗期間： 2013-10-08 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 15.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.5 (●)

Lot No.: AA1223D ; 檢驗期間： 2013-10-08 至 2015-12-31 ; 目標值 (Target) : 4.3 ; 參考標準差 (SD) : 0.3 (□)

單位 : Lab030

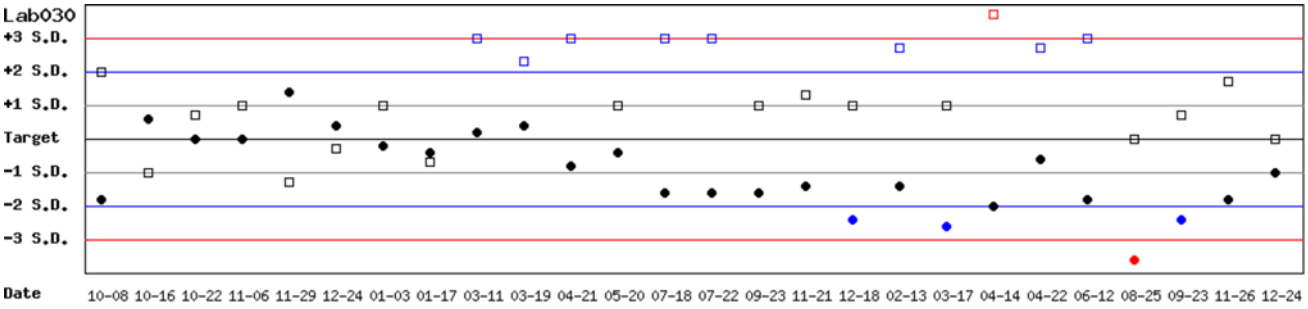

月統計： 2015 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2013 10 08 至 2015 12 31 Change

[TOP]