## G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo: AD0326N (2014-04-01 ~ 2100-12-31) Change

檢驗單位: Lab029

	Control N		Control D	
QC Control Lot No.	AD0326N		AD0326D	
檢驗期間	Month (2016/07)	CUM (2016/02/02~2016/07/31)	Month (2016/07)	CUM (2016/02/02~2016/07/31)
累計點數 (N)	4	26	4	26
累計平均值 (Mean) U/gHb	14.6	14.8	4.8	4.8
累計標準差 (SD)	0.4	0.2	0.1	0.1
累計變異係數 (CV) %	2.7	1.4	2.1	2.1
目標值 (Target) U/gHb	14.8	14.8	5.0	5.0
總誤差 (TE) %	6.8	2.7	8.2	8.2
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
σ	>6	>6	>6	>6

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)


σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計: 2016 07 Change ; 累計期間 (CUM):自 2016 02 02 至 2016 07 31 Change

[TOP]

列印圖表


## Control N SDI 分佈圖

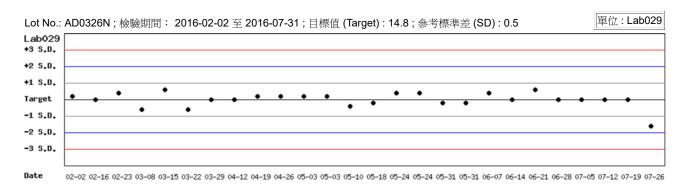

月統計: 2016 07 Change ; 累計期間 (CUM):自 2016 02 02 至 2016 07 31 Change

[TOP]


## Control D SDI 分佈圖

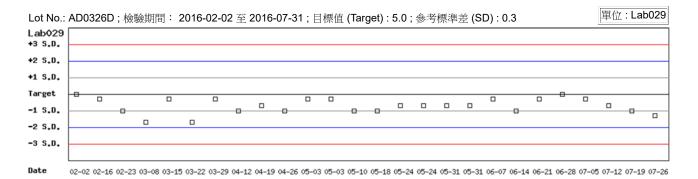

月統計: 2016 07 Change ; 累計期間 (CUM):自 2016 02 02 至 2016 07 31 Change

## Control N 及 Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AD0326N;檢驗期間: 2016-02-02至 2016-07-31;目標值 (Target): 14.8;參考標準差 (SD): 0.5 (●)

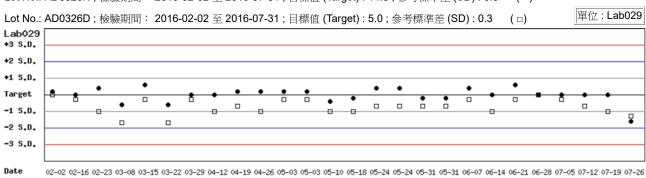

月統計: 2016 07 Change ; 累計期間 (CUM):自 2016 02 02 至 2016 07 31 Change

[TOP]