

G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo：BE0116N (2025-02-12 ~ 2100-12-31) Change

列印圖表

檢驗單位：Lab044

|                    | Control N          |                                | Control D          |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| QC Control Lot No. | BE0116N            |                                | BE0116D            |                                |
| 檢驗期間               | Month<br>(2025/12) | CUM<br>(2025/08/01~2025/12/31) | Month<br>(2025/12) | CUM<br>(2025/08/01~2025/12/31) |
| 累計點數 (N)           | 4                  | 22                             | 4                  | 22                             |
| 累計平均值 (Mean) U/gHb | 17.0               | 17.0                           | 5.8                | 5.9                            |
| 累計標準差 (SD)         | 0.8                | 0.5                            | 0.1                | 0.2                            |
| 累計變異係數 (CV) %      | 4.7                | 2.9                            | 1.7                | 3.4                            |
| 目標值 (Target) U/gHb | 16.7               | 16.7                           | 5.6                | 5.6                            |
| 總誤差 (TE) %         | 11.2               | 7.7                            | 7.0                | 12.1                           |
| 可容許總誤差 (TEa) %     | 20                 | 20                             | 20                 | 20                             |
| σ                  | 3.9                | >6                             | >6                 | 4.3                            |

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%  
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)  
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

月統計：2025 12 Change ； 累計期間 (CUM)：自 2025 08 01 至 2025 12 31 Change


[\[TOP\]](#)

Control N 及 Control D SDI 分佈圖

Lot No.: BE0116N；檢驗期間：2025-08-01 至 2025-12-31；目標值 (Target)：16.7；參考標準差 (SD)：0.90 (●)

Lot No.: BE0116D；檢驗期間：2025-08-01 至 2025-12-31；目標值 (Target)：5.6；參考標準差 (SD)：0.30 (□)

單位：Lab044

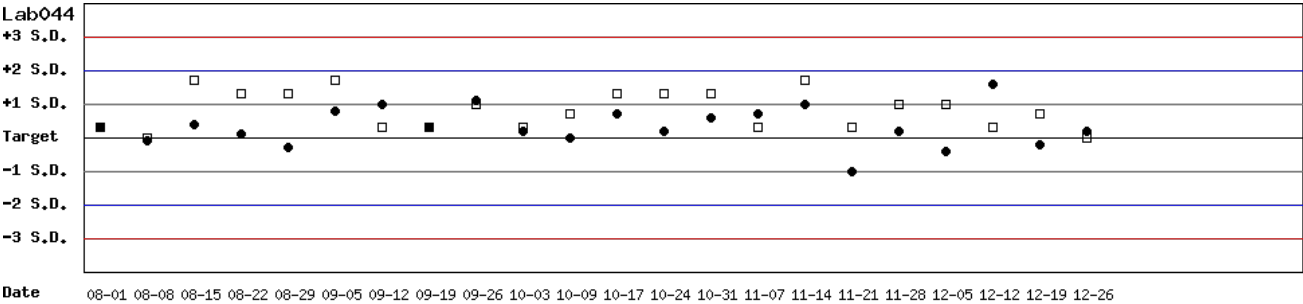


[\[TOP\]](#)

Control N SDI 分佈圖

Lot No.: BE0116N；檢驗期間：2025-08-01 至 2025-12-31；目標值 (Target)：16.7；參考標準差 (SD)：0.90

單位：Lab044

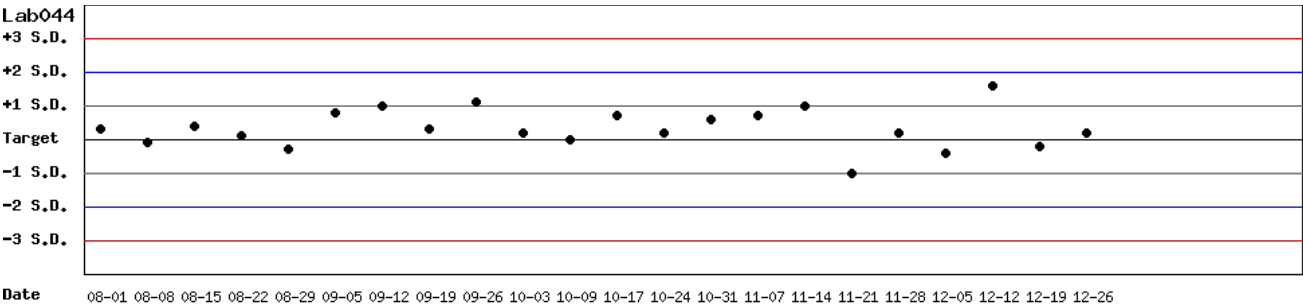


[\[TOP\]](#)

Control D SDI 分佈圖

Lot No.: BE0116D ; 檢驗期間 : 2025-08-01 至 2025-12-31 ; 目標值 (Target) : 5.6 ; 參考標準差 (SD) : 0.30

單位 : Lab044

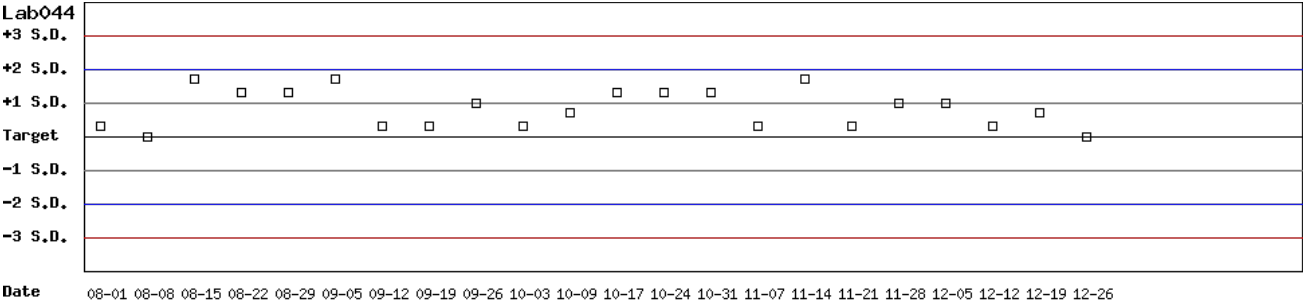

月統計 : 2025 12 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2025 08 01 至 2025 12 31 Change

各檢驗單位 **G6PD** 定量檢驗 內部品管統計結果（總表一）

選擇 LotNo：BE0116N (2025-02-12 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit：3 - Innovation Change

列印總表一

月統計表

統計月份：2025 12 Change

|                                                                                          |                                                                                                      | Control N (Lot No.: BE0116N) |              |            |     |        |        |         |     | Control D (Lot No.: BE0116D) |              |            |     |        |        |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|
| UnitID  | Reagent Kit (Code)  | Target (U/gHb)               | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   | Target (U/gHb)               | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   |
| <a href="#">Lab003</a>                                                                   | 3                                                                                                    | 14.8                         | 15.0         | 6          | 0.5 | 3.3    | 8.0    | 20      | 5.7 | 5.2                          | 5.4          | 6          | 0.2 | 3.7    | 11.3   | 20      | 4.4 |
| <a href="#">Lab009</a>                                                                   | 3                                                                                                    | 14.8                         | 14.4         | 4          | 0.3 | 2.1    | 6.9    | 20      | >6  | 5.2                          | 5.4          | 4          | 0.1 | 1.9    | 7.5    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab014</a>                                                                   | 3                                                                                                    | 14.8                         | 14.3         | 8          | 0.2 | 1.4    | 6.2    | 20      | >6  | 5.2                          | 5.0          | 8          | 0.1 | 2.0    | 7.8    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab029</a>                                                                   | 3                                                                                                    | 14.8                         | 14.4         | 5          | 0.2 | 1.4    | 5.5    | 20      | >6  | 5.2                          | 5.3          | 5          | 0.1 | 1.9    | 5.7    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab044</a>                                                                   | 3                                                                                                    | 16.7                         | 17.0         | 4          | 0.8 | 4.7    | 11.2   | 20      | 3.9 | 5.6                          | 5.8          | 4          | 0.1 | 1.7    | 7.0    | 20      | >6  |
| Total                                                                                    | -                                                                                                    | -                            | 14.9         | 27         | 1.0 | 6.7    | -      | -       | -   | -                            | 5.3          | 27         | 0.3 | 5.7    | -      | -       | -   |

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%  
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)  
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

[\[TOP\]](#)

累計統計表

累計期間：自 2025 04 01 至 2025 12 31 Change

|                                                                                            |                                                                                                        | Control N (Lot No.: BE0116N) |              |            |     |        |        |         |     | Control D (Lot No.: BE0116D) |              |            |     |        |        |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|------------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|
| UnitID  | Reagent Kit (Code)  | Target (U/gHb)               | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   | Target (U/gHb)               | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   |
| <a href="#">Lab003</a>                                                                     | 3                                                                                                      | 14.8                         | 14.6         | 149        | 0.4 | 2.7    | 6.8    | 20      | >6  | 5.2                          | 5.3          | 149        | 0.5 | 9.4    | 20.8   | 20      | 1.9 |
| <a href="#">Lab009</a>                                                                     | 3                                                                                                      | 14.8                         | 14.4         | 16         | 0.2 | 1.4    | 5.5    | 20      | >6  | 5.2                          | 5.5          | 16         | 0.1 | 1.8    | 9.4    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab011</a>                                                                     | 3                                                                                                      | 15.4                         | 15.1         | 15         | 0.2 | 1.3    | 4.6    | 20      | >6  | 5.4                          | 5.6          | 15         | 0.2 | 3.6    | 10.8   | 20      | 4.5 |
| <a href="#">Lab014</a>                                                                     | 3                                                                                                      | 14.8                         | 14.5         | 71         | 0.5 | 3.4    | 8.9    | 20      | 5.3 | 5.2                          | 5.3          | 71         | 0.3 | 5.7    | 13.2   | 20      | 3.2 |
| <a href="#">Lab029</a>                                                                     | 3                                                                                                      | 14.8                         | 14.4         | 10         | 0.3 | 2.1    | 6.9    | 20      | >6  | 5.2                          | 5.3          | 10         | 0.1 | 1.9    | 5.7    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab044</a>                                                                     | 3                                                                                                      | 16.7                         | 17.0         | 22         | 0.5 | 2.9    | 7.7    | 20      | >6  | 5.6                          | 5.9          | 22         | 0.2 | 3.4    | 12.1   | 20      | 4.3 |
| Total                                                                                      | -                                                                                                      | -                            | 14.8         | 283        | 0.8 | 5.4    | -      | -       | -   | -                            | 5.3          | 283        | 0.5 | 9.4    | -      | -       | -   |

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%  
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)  
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

[\[TOP\]](#)

| Reagent Kit | Reagent Code |
|-------------|--------------|
| Innovation  | 3            |

各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果（總表二）

選擇 LotNo : BE0116N (2025-02-12 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit : 3 - Innovation Change

列印總表二

Control N 月統計與累計統計之比較表

| Control N (Lot No.: BE0116N) |                    |                |              |            |     |        |        |         |     |                             |              |            |     |        |        |         |     |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|-----------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|
| Month (2025/12)              |                    |                |              |            |     |        |        |         |     | CUM (2025/04/01~2025/12/31) |              |            |     |        |        |         |     |
| UnitID                       | Reagent Kit (Code) | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   | Target (U/gHb)              | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   |
| <a href="#">Lab003</a>       | 3                  | 14.8           | 15.0         | 6          | 0.5 | 3.3    | 8.0    | 20      | 5.7 | 14.8                        | 14.6         | 149        | 0.4 | 2.7    | 6.8    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab009</a>       | 3                  | 14.8           | 14.4         | 4          | 0.3 | 2.1    | 6.9    | 20      | >6  | 14.8                        | 14.4         | 16         | 0.2 | 1.4    | 5.5    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab011</a>       | 3                  | 15.4           | -            | 0          | -   | -      | -      | 20      | -   | 15.4                        | 15.1         | 15         | 0.2 | 1.3    | 4.6    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab014</a>       | 3                  | 14.8           | 14.3         | 8          | 0.2 | 1.4    | 6.2    | 20      | >6  | 14.8                        | 14.5         | 71         | 0.5 | 3.4    | 8.9    | 20      | 5.3 |
| <a href="#">Lab029</a>       | 3                  | 14.8           | 14.4         | 5          | 0.2 | 1.4    | 5.5    | 20      | >6  | 14.8                        | 14.4         | 10         | 0.3 | 2.1    | 6.9    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab044</a>       | 3                  | 16.7           | 17.0         | 4          | 0.8 | 4.7    | 11.2   | 20      | 3.9 | 16.7                        | 17.0         | 22         | 0.5 | 2.9    | 7.7    | 20      | >6  |
| Total                        | -                  | -              | 14.9         | 27         | 1.0 | 6.7    | -      | -       | -   | -                           | 14.8         | 283        | 0.8 | 5.4    | -      | -       | -   |

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2025 12 Change      累計期間 (CUM) : 自 2025 04 01 至 2025 12 31 Change

[\[TOP\]](#)

Control D 月統計與累計統計之比較表

| Control D (Lot No.: BE0116D) |                    |                |              |            |     |        |        |         |     |                             |              |            |     |        |        |         |     |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|-----------------------------|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|
| Month (2025/12)              |                    |                |              |            |     |        |        |         |     | CUM (2025/04/01~2025/12/31) |              |            |     |        |        |         |     |
| UnitID                       | Reagent Kit (Code) | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   | Target (U/gHb)              | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD  | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ   |
| <a href="#">Lab003</a>       | 3                  | 5.2            | 5.4          | 6          | 0.2 | 3.7    | 11.3   | 20      | 4.4 | 5.2                         | 5.3          | 149        | 0.5 | 9.4    | 20.8   | 20      | 1.9 |
| <a href="#">Lab009</a>       | 3                  | 5.2            | 5.4          | 4          | 0.1 | 1.9    | 7.5    | 20      | >6  | 5.2                         | 5.5          | 16         | 0.1 | 1.8    | 9.4    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab011</a>       | 3                  | 5.4            | -            | 0          | -   | -      | -      | 20      | -   | 5.4                         | 5.6          | 15         | 0.2 | 3.6    | 10.8   | 20      | 4.5 |
| <a href="#">Lab014</a>       | 3                  | 5.2            | 5.0          | 8          | 0.1 | 2.0    | 7.8    | 20      | >6  | 5.2                         | 5.3          | 71         | 0.3 | 5.7    | 13.2   | 20      | 3.2 |
| <a href="#">Lab029</a>       | 3                  | 5.2            | 5.3          | 5          | 0.1 | 1.9    | 5.7    | 20      | >6  | 5.2                         | 5.3          | 10         | 0.1 | 1.9    | 5.7    | 20      | >6  |
| <a href="#">Lab044</a>       | 3                  | 5.6            | 5.8          | 4          | 0.1 | 1.7    | 7.0    | 20      | >6  | 5.6                         | 5.9          | 22         | 0.2 | 3.4    | 12.1   | 20      | 4.3 |
| Total                        | -                  | -              | 5.3          | 27         | 0.3 | 5.7    | -      | -       | -   | -                           | 5.3          | 283        | 0.5 | 9.4    | -      | -       | -   |

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2025 12 Change      累計期間 (CUM) : 自 2025 04 01 至 2025 12 31 Change

[\[TOP\]](#)

| Reagent Kit | Reagent Code |
|-------------|--------------|
| Innovation  | 3            |